



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.31.004.A № 49014

Срок действия до 20 декабря 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Газоанализаторы отходящих топочных газов переносные "Топогаз-01"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО Фирма "ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ", г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 21651-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 4215-001-18618427-11

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **20 декабря 2012 г. № 1141**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." 2012 г.

Серия СИ

№ 007921

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Газоанализаторы отходящих топочных газов переносные «Топогаз-01»

Назначение средства измерений

Газоанализаторы отходящих топочных газов переносные «Топогаз-01» (далее – газоанализаторы) предназначены для измерений концентрации кислорода, оксида углерода, оксидов азота в отходящих топочных газах промышленных топливо-сжигающих установок, а также измерений температуры, давления (разрежения) в отводящих коллекторах и расчета других параметров, характеризующих процесс сжигания газообразного и жидкого топлива.

Описание средства измерений

В основу принципа действия газоанализатора «Топогаз-01» положен электрохимический метод измерений концентрации определяемых компонентов газовой смеси, проходящей через измерительные ячейки.

Величина электрического тока, протекающего между измерительным и вспомогательным электродами в измерительной ячейке, зависит от концентрации определяемого компонента в анализируемой газовой смеси.

Чувствительными элементами (первичными преобразователями) анализатора являются:

- электрохимические ячейки на кислород, оксид углерода, оксиды азота;
- термопара и термистор для измерения температуры в месте пробоотбора и внешней температуры;
- тензорезистивный датчик измерения разности давления между атмосферным и давлением в месте пробоотбора в газоходе отходящих топочных газов.

Газоанализатор имеет встроенный контроллер на базе микропроцессора Z84, позволяющий:

- управлять режимами работы газоанализатора;
- проводить калибровку и самодиагностику прибора;
- заносить в память и сохранять результаты замеров, производить их обработку и рассчитывать по ним коэффициент тепловых потерь, коэффициент избытка воздуха, концентрацию диоксида углерода.

Газоанализатор «Топогаз-01» состоит из двух основных функциональных блоков: газового модуля и электронной системы обработки и преобразования данных.

Блок-схема газового модуля приведена на рис. 1, общий вид газоанализатора приведен на рис.2. В состав газового модуля входит пробоотборное устройство, мембранный насос, система очистки газовой пробы от жидкого конденсата и твердых частиц, система датчиков для измерения температуры, давления и концентрации компонентов анализируемого газа.

Пробоотборное устройство состоит из зонда, соединенного с дифференциальным датчиком давления dP, и вмонтированного в зонд датчика измерителя температуры T_1 топочного газа — термопара хромель/алюмель.

Система очистки газовой пробы от жидкого конденсата и твердых частиц состоит из фильтра грубой очистки со сборником конденсата и фильтра тонкой очистки.

Мембранный насос прокачивает газовую пробу на расстояние не менее 3 м от контрольной точки топливо-сжигающей установки до измерительных ячеек прибора с электрохимическими датчиками.

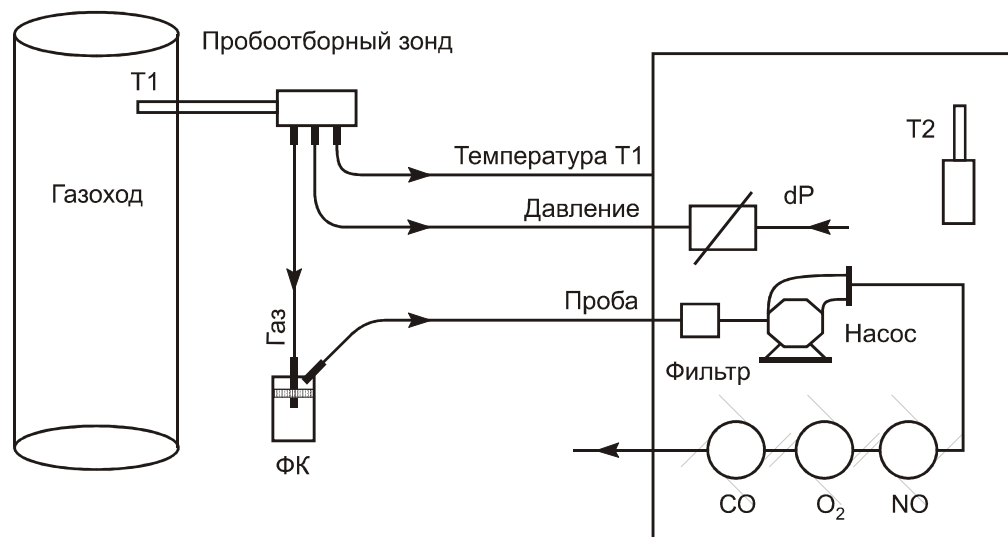


Рис. 1. Схема газового модуля газоанализатора «Топогаз-01».

ФК – фильтр грубой очистки с конденсатосборником;
CO, NO, O₂ – электрохимические датчики для измерения концентрации кислорода, оксидов углерода и азота;
dP – датчик давления;
T₁, T₂ – датчики температуры.



Рис.2 Общий вид газоанализатора «Топогаз-01»

Система измерения температуры и давления состоит из датчиков, соединенных с электронными контроллерами. Датчик давления представляет собой дифференциальный манометр и обеспечивает измерение перепада давления в месте отбора пробы. Три датчика температуры: микросхемный для измерения температуры в помещении — T_2 и два термопарных: для измерения температуры топочного газа в контрольной точке — T_1 и температуры воздуха, подаваемого для горения — T_3 .

Система измерения концентрации компонентов топочного газа состоит из последовательно соединенных специфических электрохимических датчиков для определения концентрации кислорода, оксида углерода и оксида азота в газовой пробе. Электрические сигналы от датчиков поступают в электронную систему обработки и преобразования данных.

Электронная система обработки и преобразования данных состоит из контроллеров температуры и давления, электронного модуля газоанализатора, алфавитно-цифрового жидкокристаллического дисплея и интерфейса RS-232, обеспечивающего связь газоанализатора с компьютером или печатающим устройством.

Программное обеспечение

Газоанализаторы имеют встроенное программное обеспечение (далее - ПО). Структура ПО представлена на рисунке 3.

Программное обеспечение прибора позволяет измерять, вычислять и хранить в энерго-независимой памяти показания 2000 различных замеров. При проведении 2001 замера (если никакие данные измерений не передавались на компьютер) результаты 1000 первых замеров последовательно обновляются и на их место записываются вновь поступающие данные.

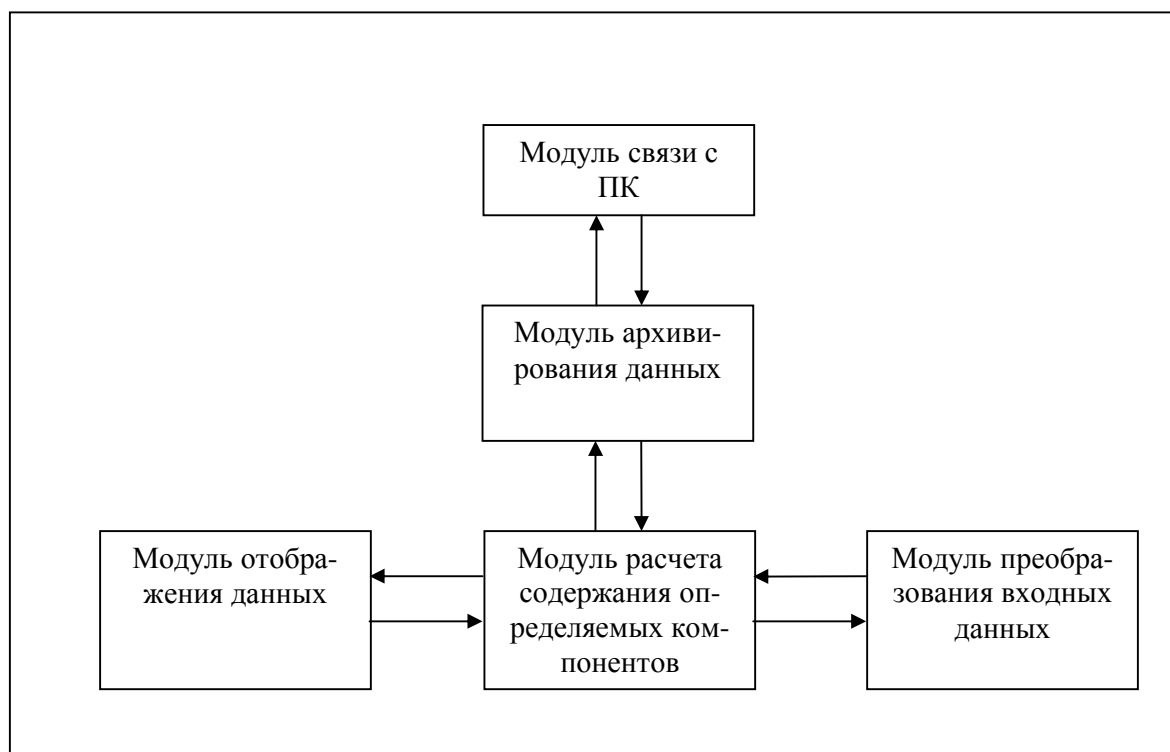


Рис. 3

- Основные функции встроенного ПО:
- вычисление концентрации CO_2 и NO_x , тепловых потерь и коэффициента избытка воздуха;
 - отображение расчетных и измеряемых данных на экране газоанализатора;
 - архивирование данных в энергонезависимой памяти;
 - связь с внешними устройствами по цифровым каналам RS232.

Идентификационные данные программного обеспечения

Таблица 1

Наименование ПО	Идентификационное наименование	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
ПО газоанализаторов «Топогаз-01»	top2007.d43	текущие	3E2E1C87	CRC-32

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений для встроенной части ПО (top2007.d43) соответствует уровню защиты «А». Не требуется специальных средств защиты, исключающих возможность несанкционированной модификации, обновления (загрузки), удаления и иных преднамеренных изменений метрологически значимой встроенной части ПО СИ и измеренных данных.

Метрологические и технические характеристики

Диапазоны измерений объемной доли:

- по каналу кислорода, % от 0 до 21
- по каналу оксида углерода, млн^{-1} от 0 до 2000
- по каналу оксидов азота, млн^{-1} от 0 до 500

Диапазон измерений температуры, $^{\circ}\text{C}$

- воздуха, подаваемого на горение от минус 10 до плюс 300
- отходящих газов от плюс 50 до плюс 450

Диапазон измерений давления (разрежения) в газоходе отходящих газов, Па от минус 5000 до плюс 5000

Пределы допускаемой основной погрешности измерений объемной доли компонентов отходящих топочных газов:

- оксида углерода:
 - в диапазоне (от 0 до 300) млн^{-1} , абсолютная, млн^{-1} ± 20
 - в диапазоне (от 300 до 2000) млн^{-1} , относительная, % ± 10
- оксидов азота, относительная, % ± 5
- кислорода:
 - в диапазоне (от 0 до 5 %), абсолютная, % $\pm 0,2$
 - в диапазоне (от 5 до 21 %), абсолютная, % $\pm 0,4$

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений параметров отходящих газов:

- температуры воздуха, подаваемого на горение, % ± 2
- температуры отходящих газов в месте установки газозаборного зонда, % ± 4
- давления в газоходе отходящих газов, % ± 4

Дополнительная погрешность измерений объемной доли компонентов топочных газов от изменения температуры окружающего воздуха в помещении установки оборудования, в долях основной погрешности на каждые 10⁰С, не более 0,2

Длительность непрерывной работы газоанализатора при автономном питании от полностью заряженной аккумуляторной батареи, ч, не менее 10

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 5

Интервал времени работы газоанализатора без корректировки показаний, ч, не менее 8

Время установления выходного сигнала при скачкообразном изменении контролируемого параметра, с, не более

– при измерении объемной доли кислорода, 60

–при измерении объемной доли оксидов азота и углерода, не более 90

– при измерении температуры и давления, не более 180

Производительность насоса (1 ± 0,3) л/мин

Время прогрева 15 мин

Цена единицы наименьшего значащего разряда измеряемой величины

– объемной доли кислорода, % 0,1

– объемной доли оксида углерода, млн⁻¹ 1

– объемной доли оксидов азота, млн⁻¹ 1

– температуры, ⁰С 1

– давления в газоходе, Па 100

Габаритные размеры, мм, не более:

– технического кейса 540 x 120 x 90

– измерительного блока газоанализатора 200 x 115 x 75

Масса газоанализатора (уложенного в технический кейс) 1,9
кг, не более

Срок службы газоанализатора, лет, не менее 10

Условия эксплуатации газоанализаторов:

диапазон температуры окружающей среды, ⁰С от плюс 5 до плюс 50

диапазон атмосферного давления, кПа от 95,7 до 106,7

мм рт.ст. от 630 до 800

относительная влажность окружающего воздуха, при температуре 35 ⁰С, %, не более 95

напряжение питания:

от сети переменного тока 220 В через адаптер 220 В/12 В ток не менее 450 мА

от встроенной аккумуляторной батареи 7,2 В

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист (центр листа) руководства по эксплуатации типографским способом, а также на табличку, расположенную на БСП, БД методом фотохимпечати.

Комплектность средства измерения

Газоанализатор «Топогаз-01».
Кабель связи с ПЭВМ.
Дискета с программным обеспечением.
Сетевой адаптер 220 В/12 В.
Устройство для дистанционного отбора проб.
Технический кейс для упаковки газоанализатора.
Паспорт и руководство по эксплуатации РЭ.
Методика поверки.

Поверка

осуществляется по документу «Инструкция. Газоанализаторы отходящих топочных газов переносные «Топогаз-01» Методика поверки» МП 4215-001-18618427-11, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 30 июля 2012 г. и входящему в комплект поставки

Основные средства поверки: ГСО-ПГС №№ 3726-87, 3730-87, 3806-87, 3808-87, 4012-87, 4013-87.

Сведения о методиках (методах) измерений

руководство по эксплуатации

Нормативные документы, устанавливающие требования к газоанализаторам «Топогаз-01»

ГОСТ 8.578-2008 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах.

ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические».

ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электрические. Общие требования безопасности».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- осуществление производственного контроля соблюдения установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта.

Изготовитель

ООО Фирма «ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ»

Адрес: 111250 г. Москва, ул. Красноказарменная, д.17, кор.Г., стр.1

Тел. 918 04 00

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений ГЦИ СИ

ФГУП «ВНИИМС», г. Москва.

Аттестат аккредитации № 30004-08 от 27.06.2008 г.

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46.

Тел./факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66

Е-mail: office@vniims.ru, адрес в Интернет: www.vniims.ru.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В.Булыгин

«_____» _____ 2012 г.