



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.011.A № 50679

Срок действия до 14 мая 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи измерительные ПИМБ-332

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное
объединение ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ" (ООО "НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ"),
г. Саров Нижегородской обл.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 53441-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ИЦФР.426442.003

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 18 месяцев

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 14 мая 2013 г. № 483

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." 2013 г.

Серия СИ

№ 009648

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователь измерительный ПИМБ-332

Назначение средства измерений.

Преобразователь измерительный ПИМБ-332 (далее – ПИ) предназначен для измерения и преобразования входных сигналов в виде напряжения постоянного тока в диапазонах от 0 до 300 В или от 0 до 150 В, или от 0 до 40 В, или от 0 до 10 В, или от 0 до 5 В в унифицированный выходной сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА.

ПИ предназначен для работы в системах автоматизации и управления технологическими процессами на предприятиях: газовой, нефтяной, химической, энергетической и других отраслей промышленности.

Описание средства измерений.

Принцип действия ПИ состоит в том, что путем схемных решений осуществляется измерение и линейное преобразование напряжения постоянного тока в выходной сигнал постоянного тока в соответствии с выражением:

$$I_{\text{вых}} = 4 + 16 \cdot U_{\text{вх}} / U_{\text{max}}$$

Где: $I_{\text{вых}}$ – значение выходного тока ПИ, мА;

$U_{\text{вх}}$ – значение входного сигнала, В;

U_{max} – максимальное значение измеряемого диапазона входных сигналов, В;

ПИ выполнен в корпусе UEGH 45/2-SMD фирмы «PHOENIX CONTACT». В корпусе установлены печатные платы (2 шт.) с навесными элементами.

Для подключения источника входного сигнала, источника питания и сопротивления нагрузки на корпусе ПИ, установлены клеммники.


На боковой поверхности корпуса имеется отверстие, обеспечивающее доступ к регулировочному резистору при настройке ПИ.

Конструкция корпуса ПИ предусматривает его установку на стандартную несущую шину (рельс) типа DIN35 NS/7,5.

ПИ содержит входной стабилизатор напряжения, магнитотранзисторный преобразователь напряжения, схемы выпрямления и фильтрации питающих напряжений, усилитель-преобразователь входного сигнала.

Схема ПИ обеспечивает взаимную гальваническую развязку входных, выходных цепей, цепей питания



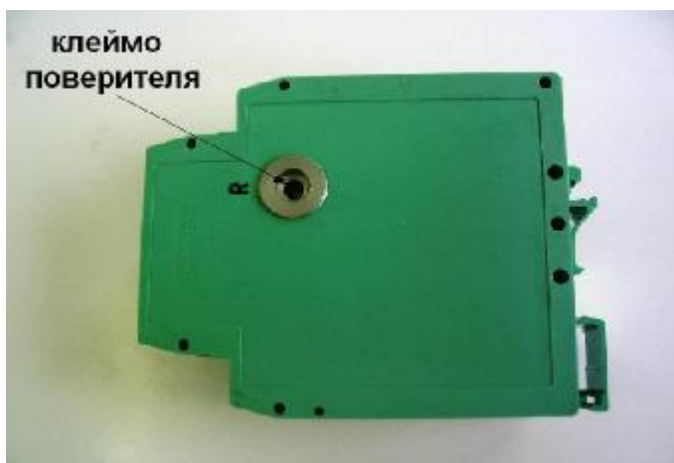

Общий вид ПИМБ-332. Место клеймения ОТК и поверителем.

Метрологические и технические характеристики

Диапазоны измерений: от 0 до 300 В, от 0 до 150 В, от 0 до 40В, от 0 до 10 В, от 0 до 5 В.

Выходной сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА.

Пределы допускаемой основной погрешности преобразования ПИ, приведенной к диапазону выходных токов не более $\pm 0,25 \%$.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности ПИ, приведенной к диапазону выходных токов, вызванной изменением температуры отличной от $(20,0 \pm 5,0) ^\circ\text{C}$ не более $\pm 0,1 \%$ на каждые $10 ^\circ\text{C}$.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, приведенной к диапазону выходных токов, обусловленной изменением напряжения питания от номинального до любого напряжения от 19 до 30 В, не более $\pm 0,1\%$.

ПИ работоспособен при питании от источника постоянного тока напряжением (24^{+6}_{-5}) В.

Номинальное значение сопротивления нагрузки – 250 Ом.

Допустимое значение сопротивления нагрузки от 10 до 500 Ом.

Ток потребления ПИ не более 50 мА в рабочем режиме.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающей среды ПИ соответствует группе С2 по ГОСТ Р 52931-2008, в диапазоне температур от -50°C до $+70^\circ\text{C}$.

ПИ устойчив к воздействию синусоидальной вибрации с параметрами по группе исполнения F3 ГОСТ Р 52931-2008.

Степень защиты ПИ от проникновения пыли, посторонних тел и воды соответствует группе IP 20 ГОСТ 14254-96.

Масса ПИ $(0,255 \pm 0,025)$ кг.

Габаритные размеры не более: Высота: 107 мм, Ширина: 45 мм Длина: 79мм

Среднее время наработки на отказ не менее 100000 часов.

Срок службы ПИ 12,5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 2 года с момента изготовления.

Знак утверждения типа.

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации, формуляр типографским способом и на корпус ПИ методом фотохимпечати.

Комплектность средства измерений.

ПИ поставляются в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Кол-во
Преобразователь измерительный ПИМБ-332	ИЦФР.426442.003	1
Руководство по эксплуатации	ИЦФР.426442.003РЭ	См. примечание
Формуляр	ИЦФР.426442.003ФО	
Методика поверки	ИЦФР.426442.003	

Примечание – Руководство по эксплуатации ИЦФР.426442.003РЭ поставляется из расчета 1 экз. на каждые 10 преобразователей измерительных ПИМБ-332. Если партия менее 10 преобразователей, поставляется один экземпляр ИЦФР.426442.003РЭ.

Поверка

осуществляется по документу ИЦФР.426442.003 «Преобразователь измерительный ПИМБ-332. Методика поверки», утвержденному руководителем ГЦИ СИ ФБУ «Нижегородский ЦСМ» в октябре 2012 г.

Основные средства поверки:

- калибратор-вольтметр универсальный В1-28;
- вольтметр универсальный цифровой В7-34А;
- магазин сопротивлений Р33;
- мера электрического сопротивления однозначная Р321 10 Ом;
- источник постоянного тока Б5-44 А.

Сведения о методиках (методах) измерений.

Методы измерений изложены в руководстве по эксплуатации «Преобразователь измерительный ПИМБ-332. Руководство по эксплуатации ИЦФР.426442.003РЭ».

Нормативные документы, устанавливающие требования к преобразователю измерительному ПИМБ 332:

ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов.

Общие технические условия»;

ГОСТ 51350-99 «Безопасность электрических контрольно- измерительных приборов и лабораторного оборудования»;

ГОСТ 51522-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний».

Технические условия ИЦФР.426442.003 ТУ.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Преобразователи измерительные могут применяться для осуществления производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации

требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ» (ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ»),
607190, г. Саров, Нижегородской обл., ул. Железнодорожная, д. 4/1.

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФБУ "Нижегородский ЦСМ" аккредитован и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 30011-08, действителен до 01.01.2014 г.
Россия, 603950 г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д.1 Тел./факс (831) 428-78-78
E-mail: ncsmnpov@sinn.ru

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

_____ Ф.В. Булыгин

М.п. «___» _____ 2013 г.